


# ファットスプレッド

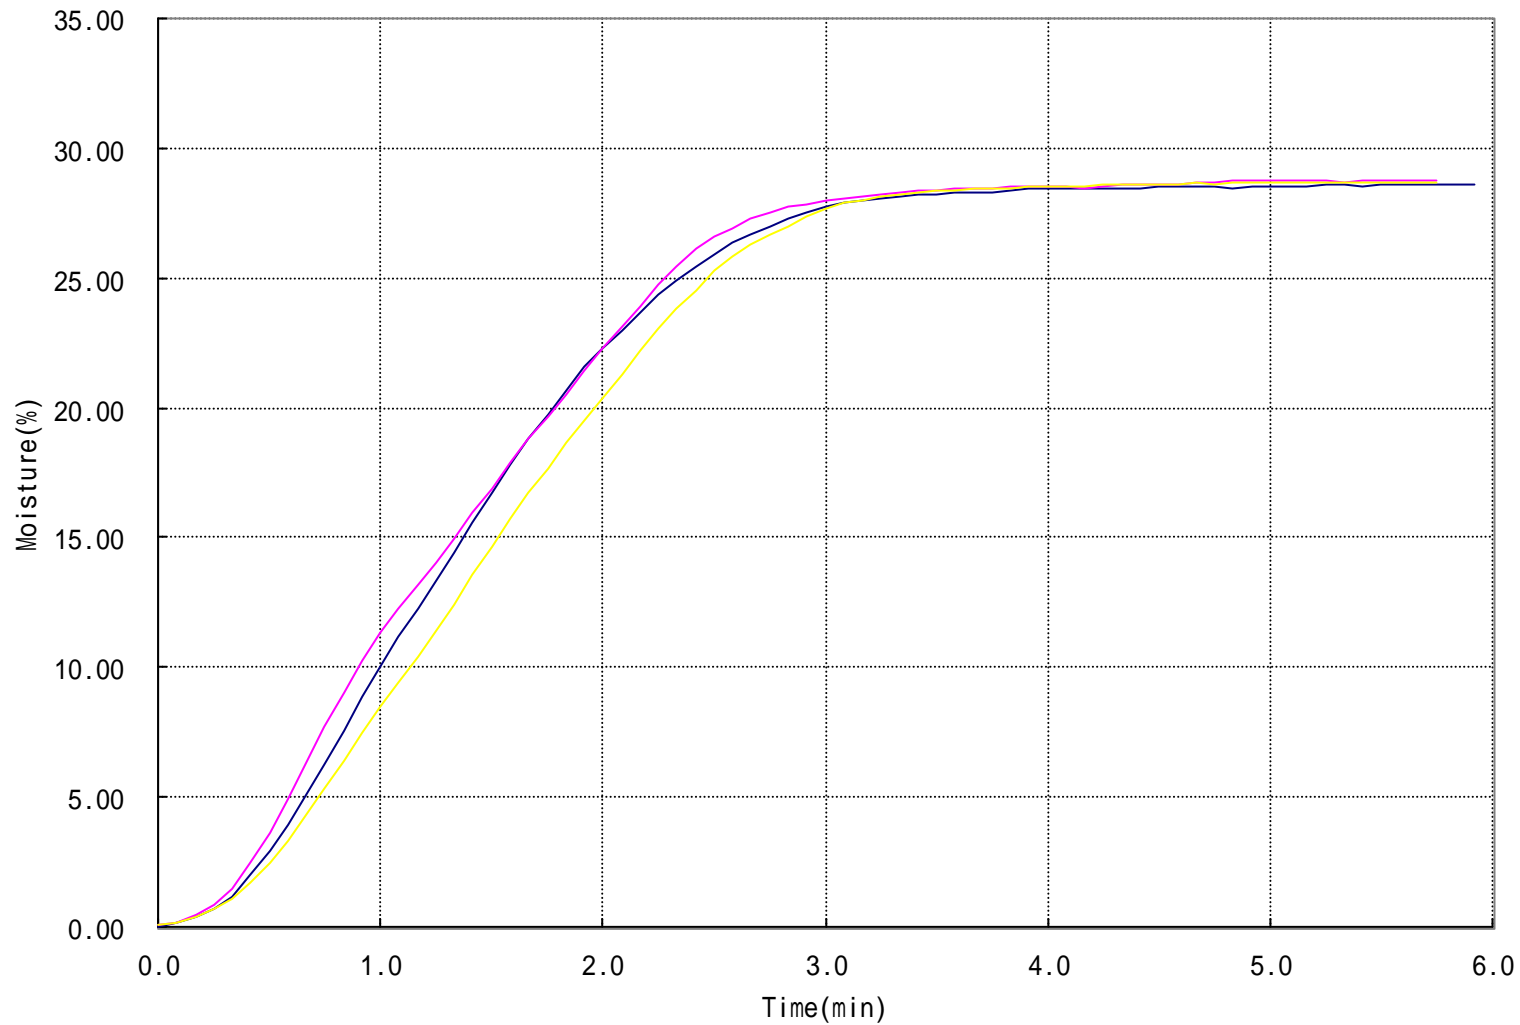

測定機種:MX-50  
測定条件:標準モード  
(測定精度:M I D)  
試料質量 1g  
試料皿温度 140  
平均測定時間 5.8分  
水分率  
    平均値 28.67%  
    再現性 0.060%  
    C V 値 0.21%

— 1回目 28.61%  
— 2回目 28.73%  
— 3回目 28.67%