


活性炭素（粒子状、消臭剤用）

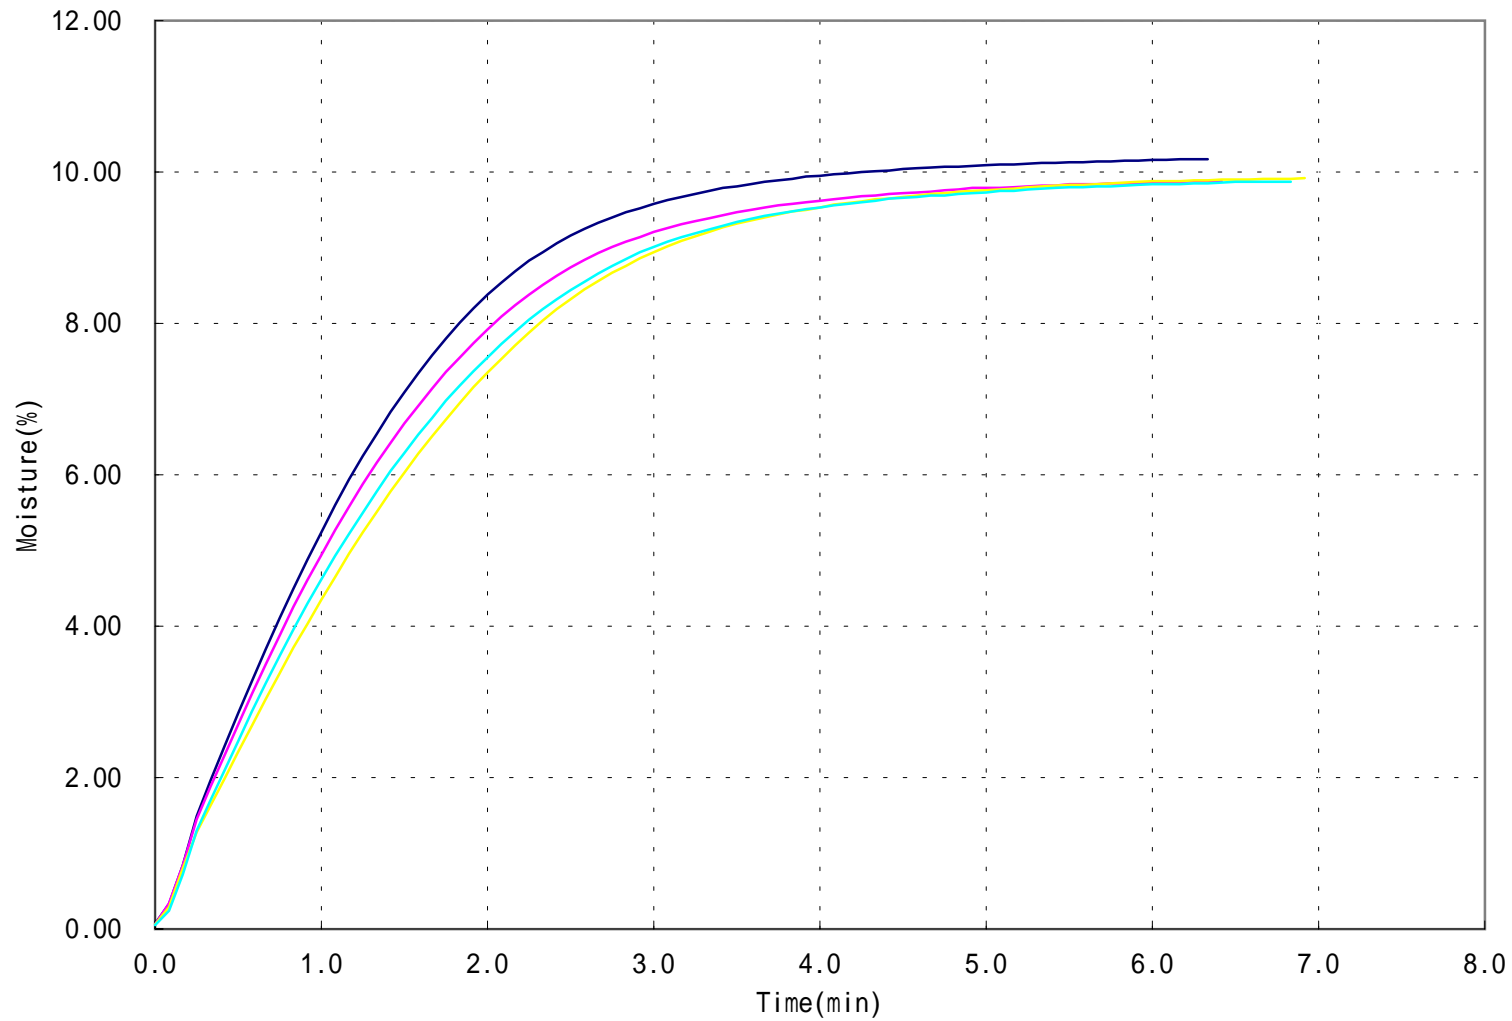

測定機種:MX-50
測定条件:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 5g
試料皿温度 120
平均測定時間 6.6分
水分率
 平均値 9.96%
 再現性 0.142%
 C V 値 1.43%

— 1回目 10.17%
— 2回目 9.88%
— 3回目 9.92%
— 4回目 9.87%