


ハンドソープ(液体)

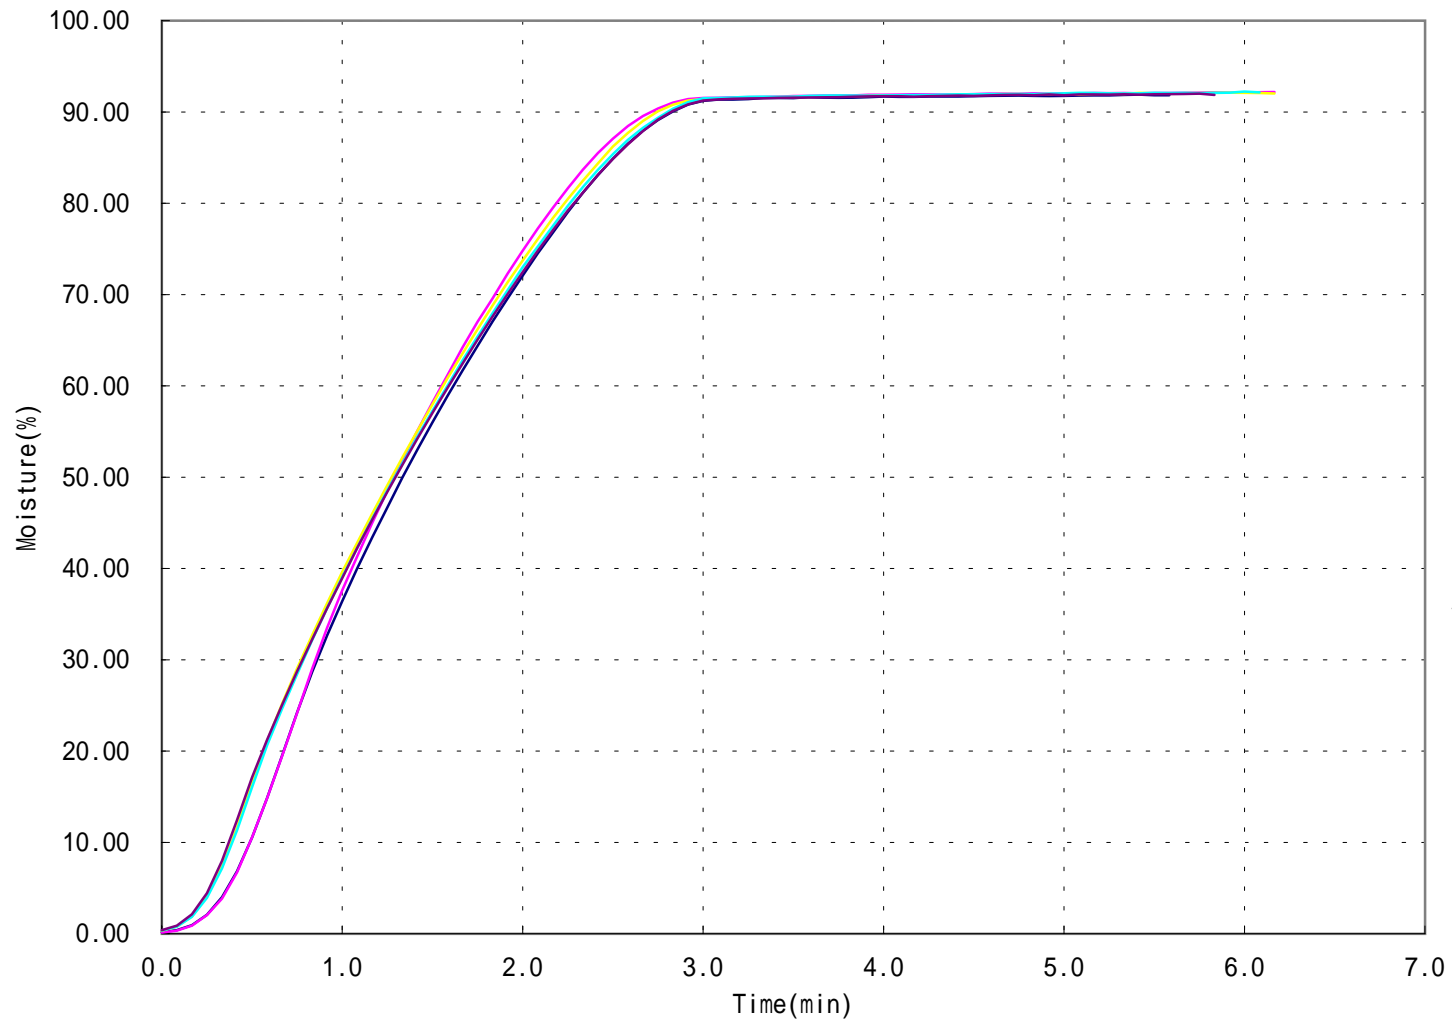

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 6.0分
水分率

平均値 92.01%
再現性 0.157%
C V 値 0.17%

1回目 91.84%
2回目 92.19%
3回目 92.03%
4回目 92.14%
5回目 91.87%

備考:
ガラス繊維シート使用