


木工用ボンド(ペースト)

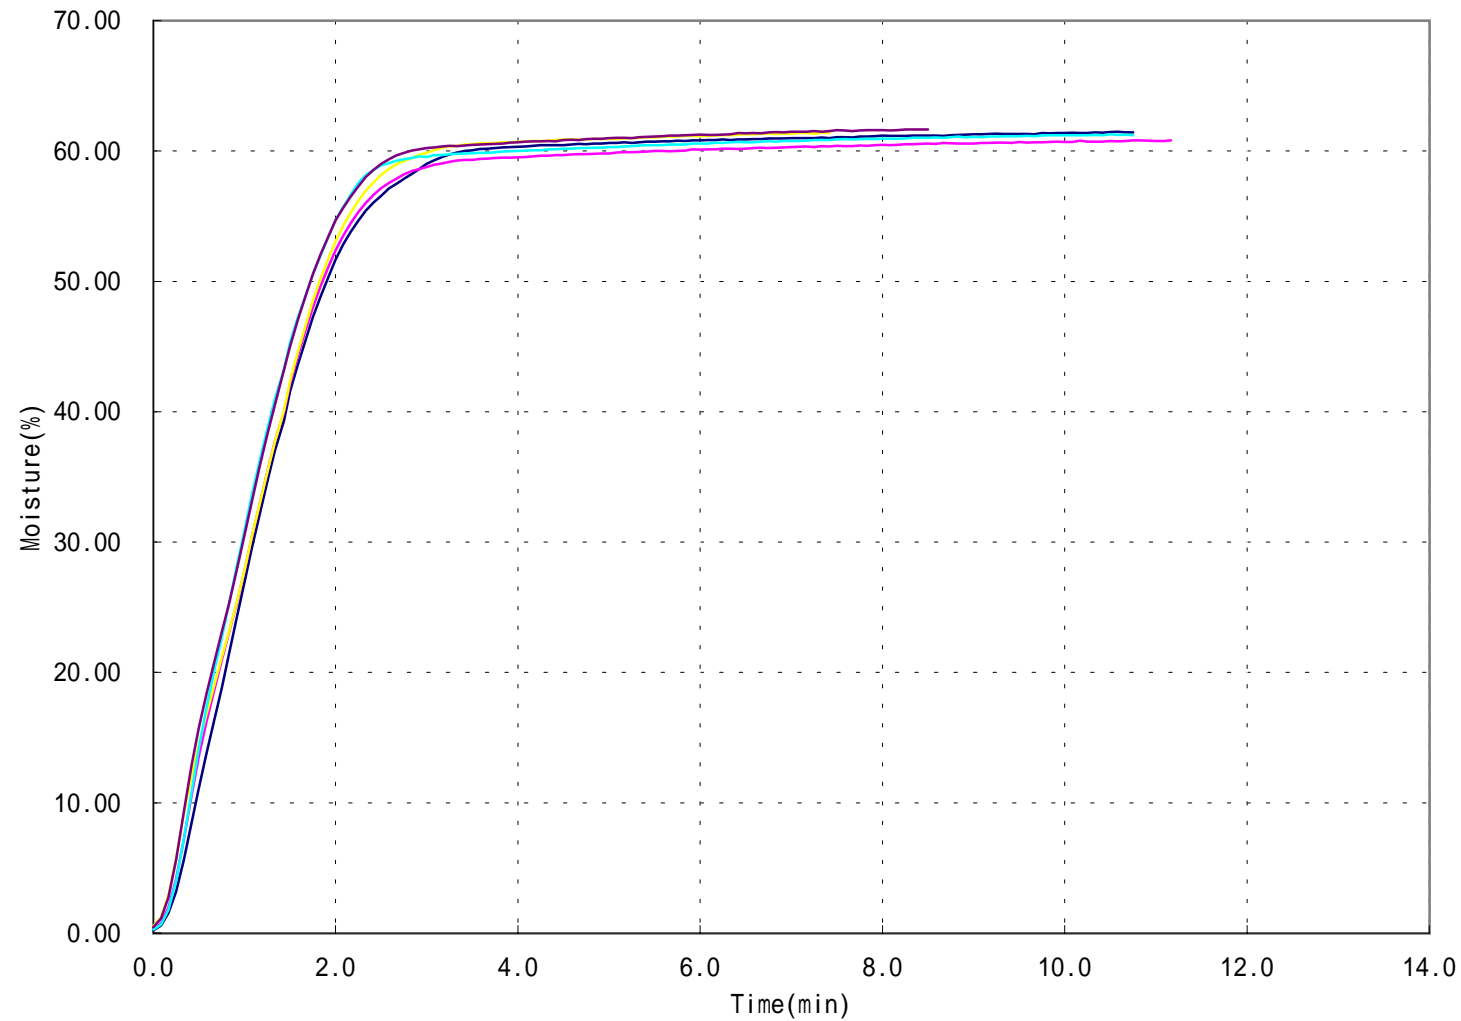

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 9.7分
水分率

平均値 61.30%
再現性 0.309%
C V 値 0.50%

— 1回目 61.43%
— 2回目 60.82%
— 3回目 61.37%
— 4回目 61.22%
— 5回目 61.65%

備考:
試料を均一に広げて測定