


オレンジジュース(濃縮還元)

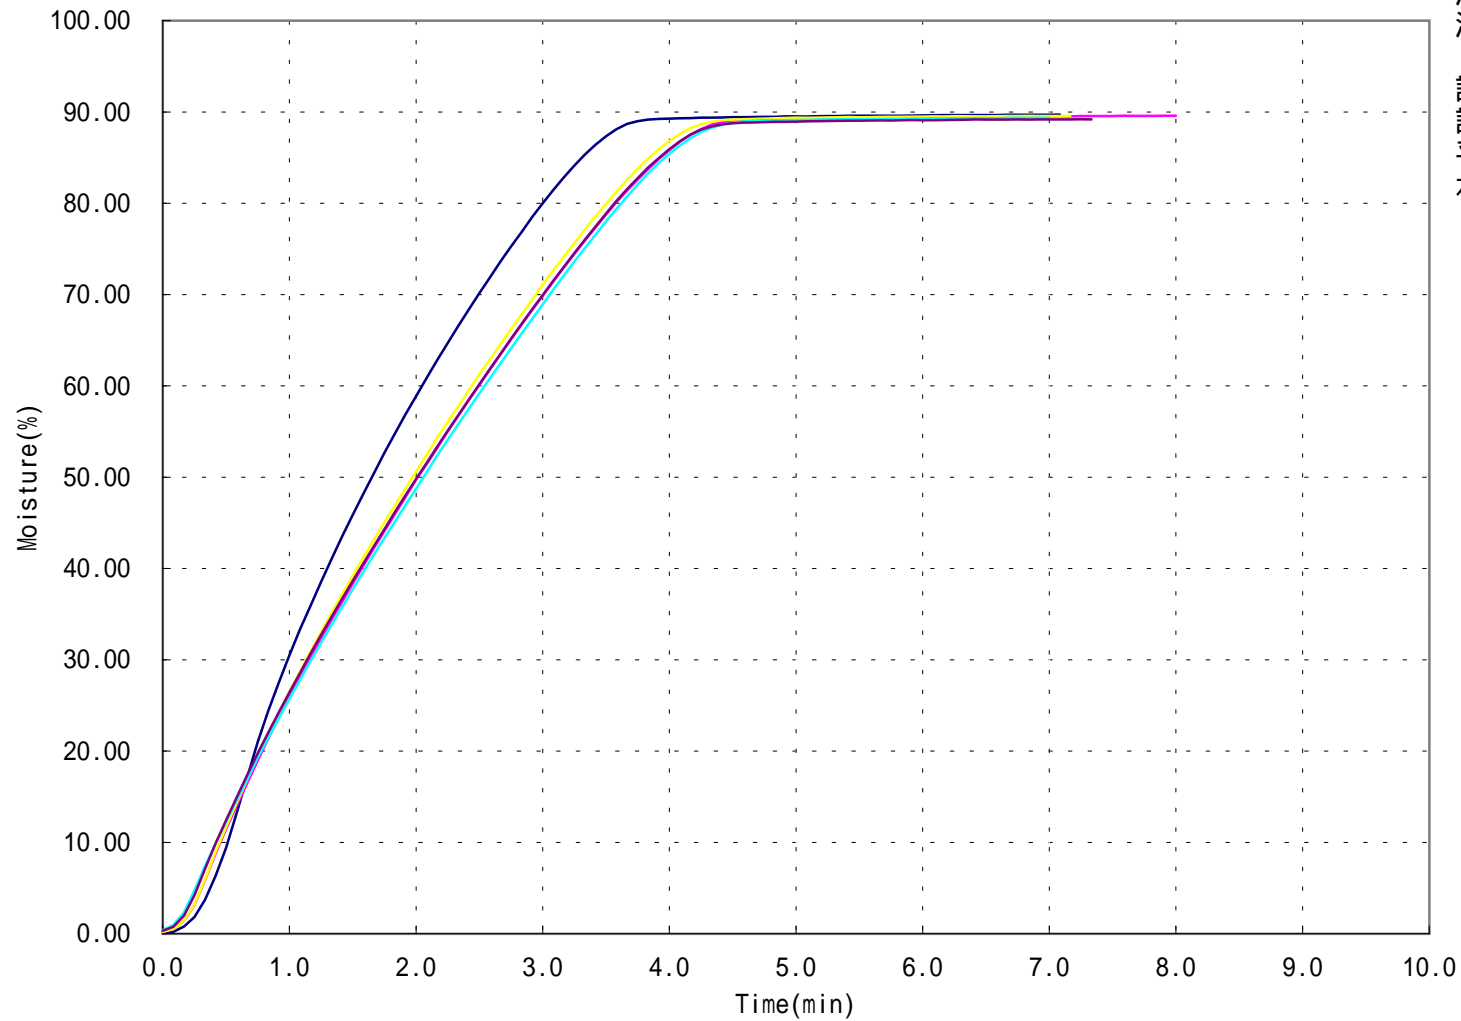

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 140
平均測定時間 7.3分

水分率
平均値 89.48%
再現性 0.209%
C V 値 0.23%

1回目 89.71%
2回目 89.58%
3回目 89.57%
4回目 89.36%
5回目 89.18%

備考:
ガラス繊維シート使用